



変動情報入り GS1 バーコード対応のお知らせ

フルオール[®]液 歯科用 2%


株式会社ビーブランド・メディコーデンタル

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社並びに弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度ご愛顧賜っております「フルオール液歯科用 2%」の容器に表示している GS1 バーコードを、平成 28 年 8 月 30 日付通知『医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項』の一部改正について（医政経発 0830 第 1 号・薬生安発 0830 第 1 号・薬生監麻発 0830 第 1 号）に基づき、使用期限・製造番号を含む変動情報入り GS1 バーコードに変更いたしましたので、ご案内申し上げます。

謹白

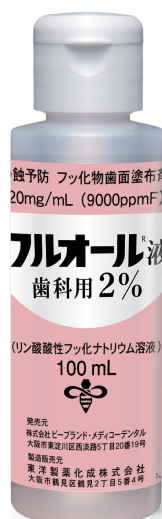

1 対象製品

フルオール液歯科用 2%

2 変更内容

2-1 製品容器への印字からラベル貼付に変更

2-2 変動情報入り GS1 バーコードを記載



2-3 製品容器底面への製造番号・使用期限の印字を廃止し、ラベルに記載

2. 変更内容

2-1 製品容器への印字からラベル貼付に変更

2-2 変動情報入り GS1 バーコードを記載

2-3 製品容器底面への製造番号・使用期限の印字を廃止し、ラベルに記載

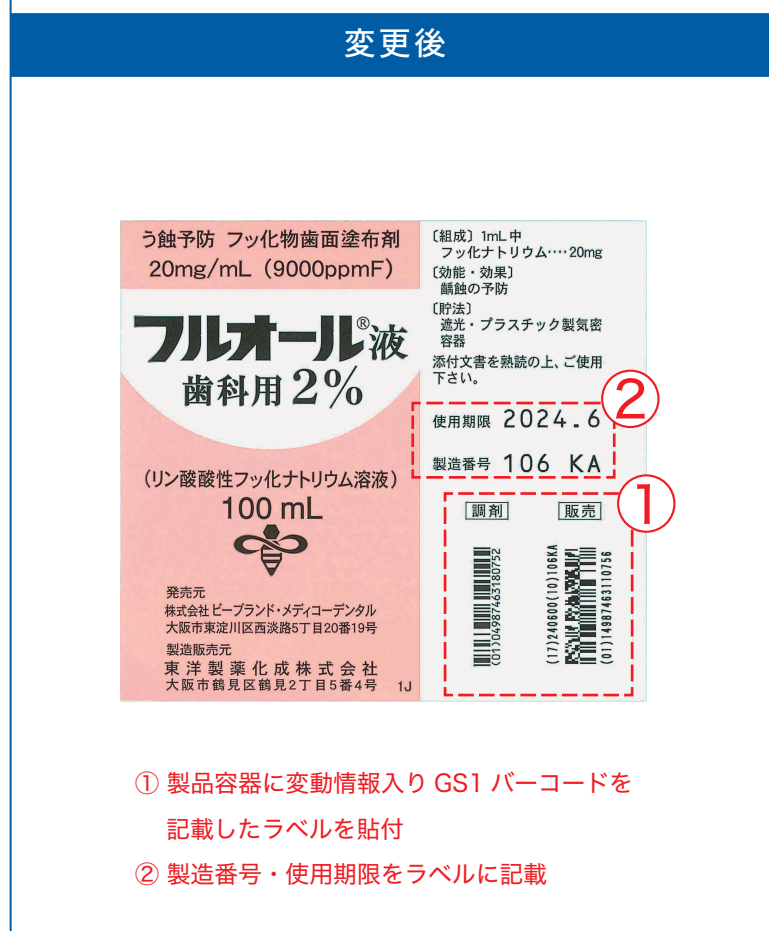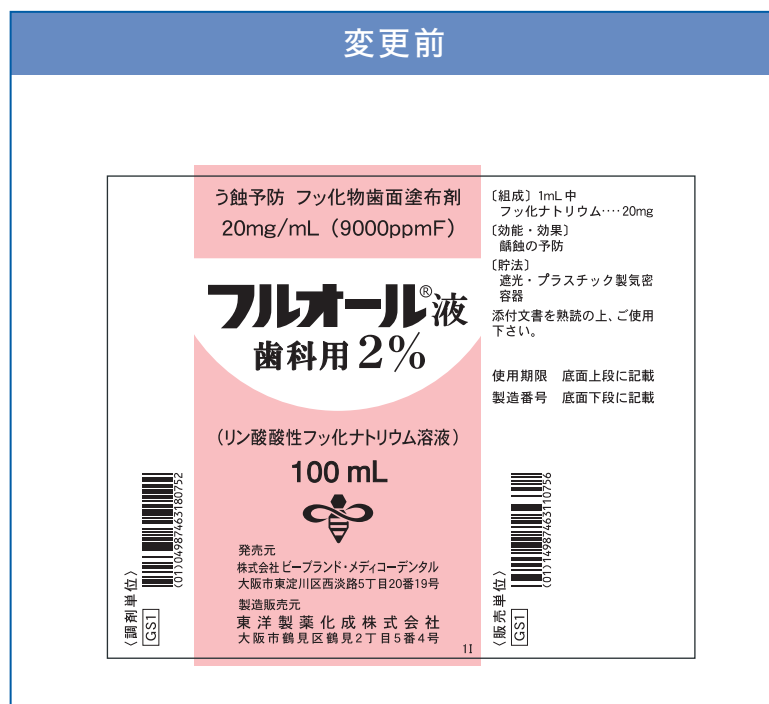

3 変更品の製造番号及び出荷時期

製造番号：106KA

出荷時期(予定)：2021 年 9 月頃

※出荷時期は若干前後することがありますので、ご了承ください。